



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
(наименование аккредитующего органа)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КООРДИНАЦИОННО – ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО»**
(наименование поверочной лаборатории)

109029, г. Москва, Сибирский пр-д, д. 2, стр. 11, аттестат № РОССТРУ.0001.310033
www.trxline.ru (раздел «Услуги»); тел.: (495) 737-67-19; e-mail: info@trxline.ru; vs-kia@rambler.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 18.12.Д.18а

Действительно до « 23 » декабря 2019 г.

Средство измерений Анализатор кабельный DSX-5000, 55870-13
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
основной и удаленный блоки с модулями DSX-5000 № 2405199 и № 2405169 и
(если в состав средства измерений входит несколько автономных измерительных блоков, то
адаптеры DSX-CHA004 № 2433040 и № 2511203, DSX-PLA004 № 2449045 и № 2450036
приводится их перечень и заводские номера)

отсутствуют

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) № 2395531 / № 2378142

поверено в соответствии с описанием типа

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с МП 55870-13

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: катушка эталонная UTP 4PR 24AWG CAT5e № 02

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии),
разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура 21°C, относительная влажность 50 %
приводят перечень влияющих факторов, нормированных
атмосферное давление 98,0 кПа
в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим
установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению
в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки



Главный метролог
должность руководителя подразделения

подпись

В.В. Супрунюк
инициалы, фамилия

Поверитель

подпись

Б.П. Алексеев
инициалы, фамилия

Дата поверки « 24 » декабря 2018 г.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

US.C.34.002.A № 71687

Срок действия до 26 октября 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Анализаторы кабельные DSX-600, DSX-5000 Versiv, DSX-5000 Versiv2,
DSX-8000 Versiv, DSX-8000 Versiv2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "Fluke Corporation", США

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 72897-18

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП-610-005-2018

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 26 октября 2018 г. № 2252

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



..... 2018 г.

Серия СИ

№ 033037

Отчет о калибровке

№: Demo2019

Мы гарантируем, что данный прибор отвечает заводской спецификации в измеренных точках. Калибровка выполняется в полном соответствии с действующими национальными и международными стандартами, а также, с нормами и регламентами, принятыми в компании FlukeNetworks. Данный сертификат содержит полную информацию и не действителен без подписи и печати.

Модель	DSX-5000
Серийный номер	2405169
Прибор	Кабельный анализатор
Производитель	Fluke Networks
Номер контракта GOLD	-----
Количество страниц	5
Дата калибровки	01.07.2019
Дата повторной калибровки	30.06.2020
Калибровку выполнил	Сервисный инженер
	 /Фильков С.В./
Проверил	Сервисный инженер
	 /Фильков С.В./



Отчет о калибровке

№: Demo2019

Дата калибровки
01.07.2019

Наименование

Прибор DSX-5000
Серийный номер 2405169
Номер контракта GOLD -----

Условия окружающей среды

Температура помещения (23±1) °C
Влажность (40±10) %RH

Результаты калибровки

Процедура выполнена
Количество неудачных испытаний 0
Заключение прибор соответствует спецификации
Калибровку выполнил Фильков С.В.
Место калибровки г.Москва
Процедура калибровки TFS Test V1.5.5273, ручной режим

Примечания

Если прибор используется в тяжелых условиях, то мы рекомендуем уменьшить интервал между повторными калибровками. За соблюдение межкалибровочного интервала ответственность несет владелец прибора.

Модель	Серийный номер	Номер набора	Срок калибровки	Номер сертификата
DSX-VER NEXT ARTIFACT	2409056	DSX-VER E000015	12.04.2020	FNET2019/E000015
DSX-VER CDNEXT ARTIFA	2405145	DSX-VER E000015	12.04.2020	FNET2019/E000015
DSX-VER CMDMRL ARTIF	2409153	DSX-VER E000015	12.04.2020	FNET2019/E000015
DSX-VER TCL ARTIFACT	2402080	DSX-VER E000015	12.04.2020	FNET2019/E000015
DSX-VER IL/FEXT ARTIFA	2402053	DSX-VER E000015	12.04.2020	FNET2019/E000015
DSX-VER LOOP RESISTAN	2402252	DSX-VER E000015	12.04.2020	FNET2019/E000015
DSX-VER RES UNBALANC	2402284	DSX-VER E000015	12.04.2020	FNET2019/E000015

As-Left Report


Model **DSX-5000 CAT 6A/CLASS Fa 1000MHz Copper Module**
Serial Number **2405169**

Test date **1-Jul-19**

Page 1 of 3

NEXT


NEXT Artifact SN **2409056**

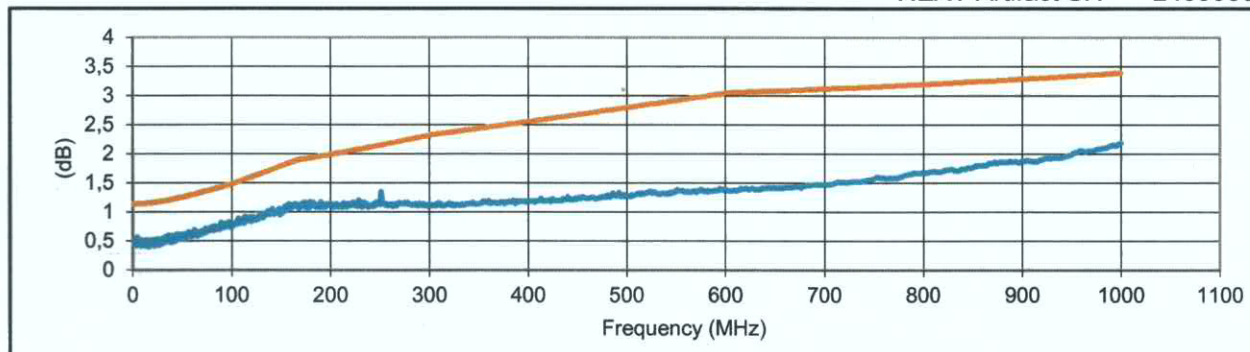

Pass Worst margin: 0.580 at 4.13 MHz in pair 12-78. Worst accuracy at each frequency shown.

CDNEXT


CDNEXT Artifact SN **2402145**

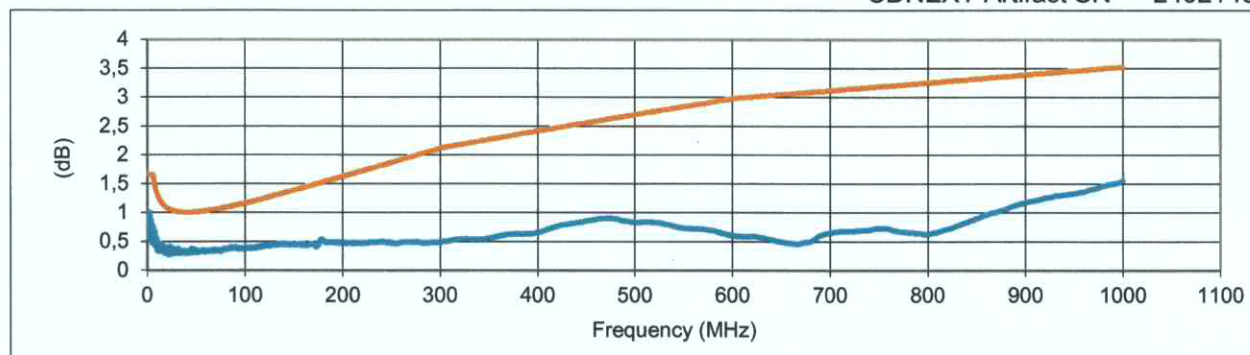

Pass Worst margin: 0.630 at 31.75 MHz in pair 12-36. Worst accuracy at each frequency shown.

CMRL

CMDMRL Artifact SN **2409153**

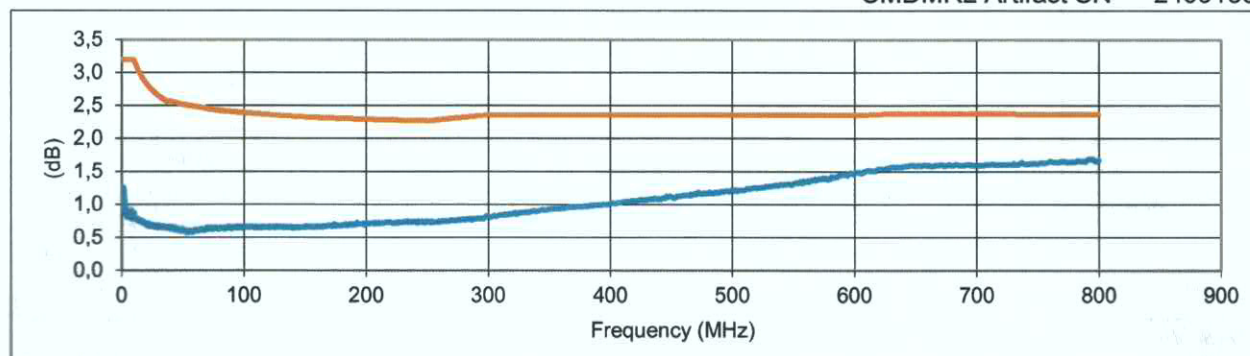

Pass Worst margin: 0.680 at 792 MHz in pair 12. Worst accuracy at each frequency shown.

- Measured difference of DSX and reference laboratory equipment added to measurement accuracy of reference laboratory equipment. Worst accuracy at each frequency shown.
- Corresponding measurement accuracy requirement for nominally compliant Level IV or Level 2G/VI field tester.

As-Left Report

Model

DSX-5000 CAT 6A/CLASS Fa 1000MHz Copper Module

Serial Number


2405169

Test date 1-Jul-19

Page 2 of 3

RL


CMDMRL Artifact SN 2409153

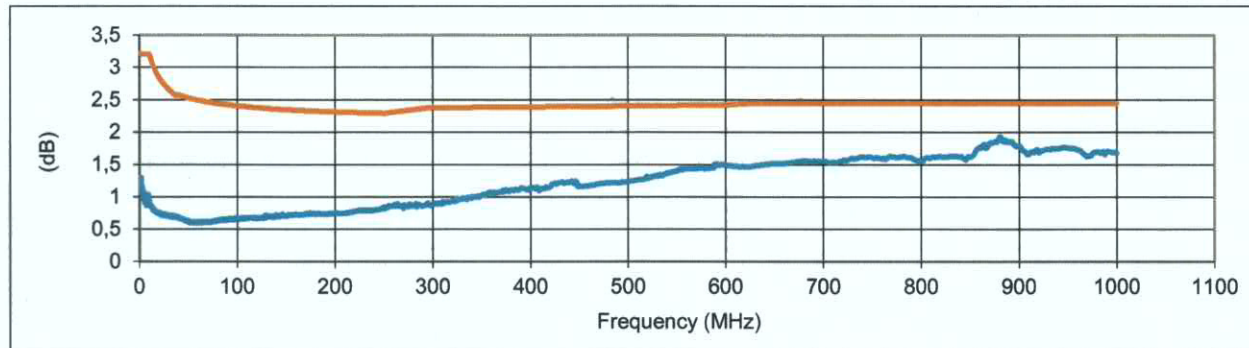

Pass Worst margin: 0.510 at 881 MHz in pair 12. Worst accuracy at each frequency shown.

TCL


TCL Artifact SN 2402080

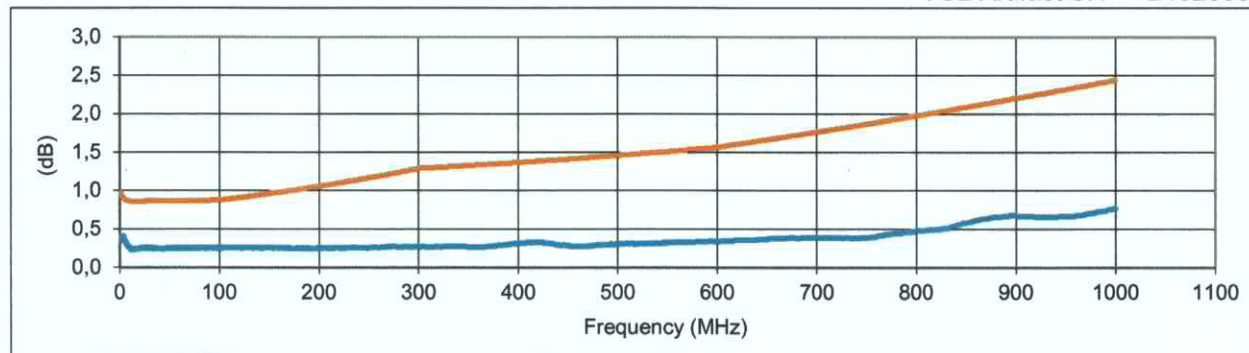

Pass Worst margin: 0.490 at 3.88 MHz in pair 45. Worst accuracy at each frequency shown.

IL

ILFEXT Artifact SN 2402053

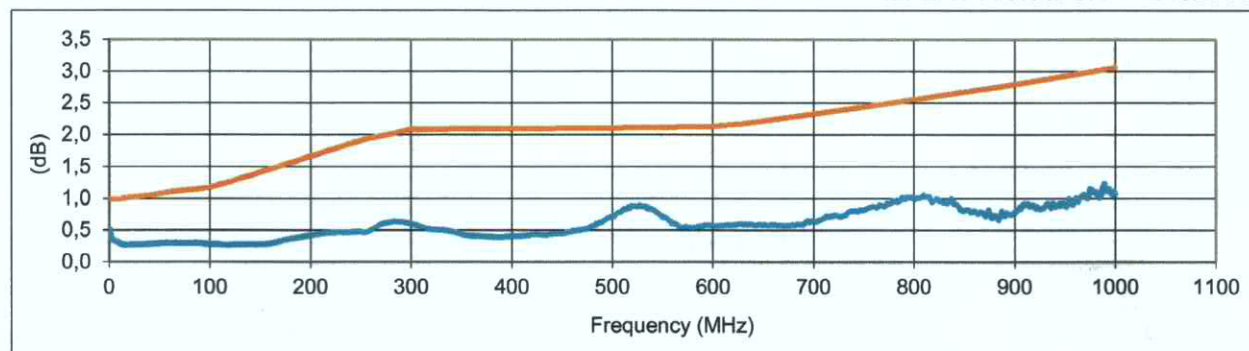

Pass Worst margin: 0.480 at 1 MHz in pair 78. Worst accuracy at each frequency shown.

- Measured difference of DSX and reference laboratory equipment added to measurement accuracy of reference laboratory equipment. Worst accuracy at each frequency shown.
- Corresponding measurement accuracy requirement for nominally compliant Level IV or Level 2G/VI field tester.

As-Left Report

Model **DSX-5000 CAT 6A/CLASS Fa 1000MHz Copper Module**


Serial Number **2405169**

Test date **1-Jul-19**

Page 3 of 3

FEXT

ILFEXT Artifact SN **2402053**

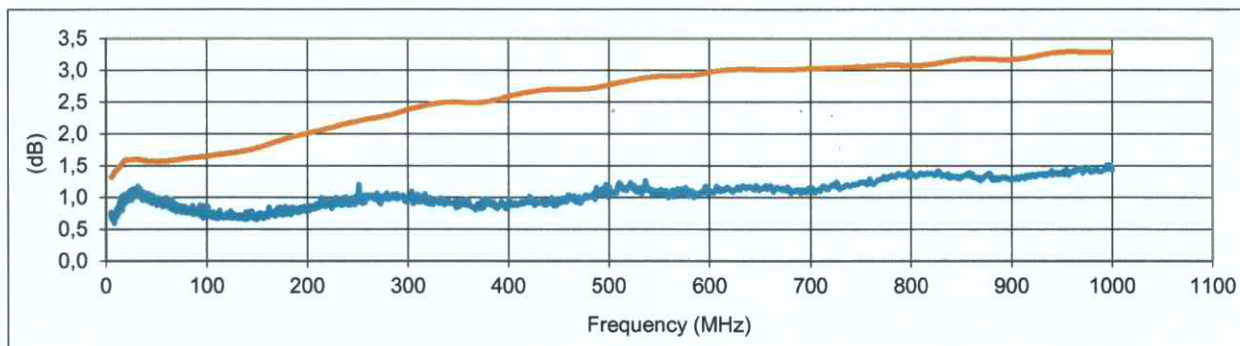

Pass Worst margin: 0.430 at 31.5 MHz in pair 12-78. Worst accuracy at each frequency shown.

— Measured difference of DSX and reference laboratory equipment added to measurement accuracy of reference laboratory equipment. Worst accuracy at each frequency shown.

— Corresponding measurement accuracy requirement for nominally compliant Level IV or Level 2G/VI field tester.

Loop Resistance

Loop Resistance Artifact SN **2402252**

	Measured	Expected	Limit	
Resistance on pair 12	0,19	0,00	0,80	Pass
Resistance on pair 36	49,93	49,80	0,60	Pass
Resistance on pair 45	99,90	99,80	1,60	Pass
Resistance on pair 78	453,00	453,00	4,00	Pass

Resistance imbalance

Resistance Unbalance Artifact SN **2402284**

	Measured	Expected	Limit	
Resistance on pair 12	0,12	0,00	0,80	Pass
Resistance on pair 36	25,01	24,90	0,90	Pass
Resistance on pair 45	12,15	12,13	0,90	Pass
Resistance on pair 78	24,11	24,05	0,90	Pass
Resistance imbalance on pair 12	0,02	0,00	0,05	Pass
Resistance imbalance on pair 36	0,01	0,00	0,13	Pass
Resistance imbalance on pair 45	0,33	0,32	0,06	Pass
Resistance imbalance on pair 78	0,84	0,85	0,12	Pass

DSX-8000 only: M_IL and M_FEXT measurements validate the ability of the DSX-8000 to make measurements with DSX-5000 adapters.

M IL Not applicable

M_ILFEXT Artifact SN **-**

M FEXT Not applicable

M_ILFEXT Artifact SN **-**

Test Program **TFSTest v2.5.7025**
DSX Report Form **v3.05 18-May-2017**

Отчет о калибровке

№: Demo2019

Мы гарантируем, что данный прибор отвечает заводской спецификации в измеренных точках. Калибровка выполняется в полном соответствии с действующими национальными и международными стандартами, а также, с нормами и регламентами, принятыми в компании FlukeNetworks. Данный сертификат содержит полную информацию и не действителен без подписи и печати.

Модель	DSX-5000
Серийный номер	2405199
Прибор	Кабельный анализатор
Производитель	Fluke Networks
Номер контракта GOLD	-----
Количество страниц	5
Дата калибровки	01.07.2019
Дата повторной калибровки	30.06.2020
Калибровку выполнил	Сервисный инженер
	 /Фильков С.В./
Проверил	Сервисный инженер
	 /Фильков С.В./



Отчет о калибровке

№: Demo2019

Дата калибровки
01.07.2019

Наименование

Прибор	DSX-5000
Серийный номер	2405199
Номер контракта GOLD	-----

Условия окружающей среды

Температура помещения	(23±1) °C
Влажность	(40±10) %RH

Результаты калибровки

Процедура	выполнена
Количество неудачных испытаний	0
Заключение	прибор соответствует спецификации
Калибровку выполнил	Фильков С.В.
Место калибровки	г.Москва
Процедура калибровки	TFSTest V1.5.5273, ручной режим

Примечания

Если прибор используется в тяжелых условиях, то мы рекомендуем уменьшить интервал между повторными калибровками. За соблюдение межкалибровочного интервала ответственность несет владелец прибора.

Модель	Серийный номер	Номер набора	Срок калибровки	Номер сертификата
DSX-VER NEXT ARTIFACT	2409056	DSX-VER E000015	12.04.2020	FNET2019/E000015
DSX-VER CDNEXT ARTIFA	2405145	DSX-VER E000015	12.04.2020	FNET2019/E000015
DSX-VER CMDMRL ARTIF	2409153	DSX-VER E000015	12.04.2020	FNET2019/E000015
DSX-VER TCL ARTIFACT	2402080	DSX-VER E000015	12.04.2020	FNET2019/E000015
DSX-VER IL/FEXT ARTIFA	2402053	DSX-VER E000015	12.04.2020	FNET2019/E000015
DSX-VER LOOP RESISTAN	2402252	DSX-VER E000015	12.04.2020	FNET2019/E000015
DSX-VER RES UNBALANC	2402284	DSX-VER E000015	12.04.2020	FNET2019/E000015


As-Left Report

Model **DSX-5000 CAT 6A/CLASS Fa 1000MHz Copper Module**
Serial Number **2405199**

Test date **1-Jul-19**
Page 1 of 3


NEXT

NEXT Artifact SN **2409056**

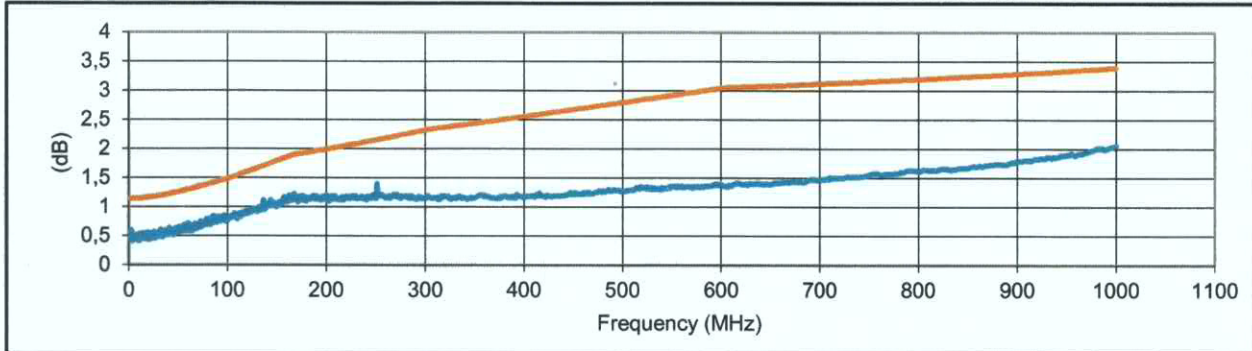


CDNEXT

CDNEXT Artifact SN **2402145**

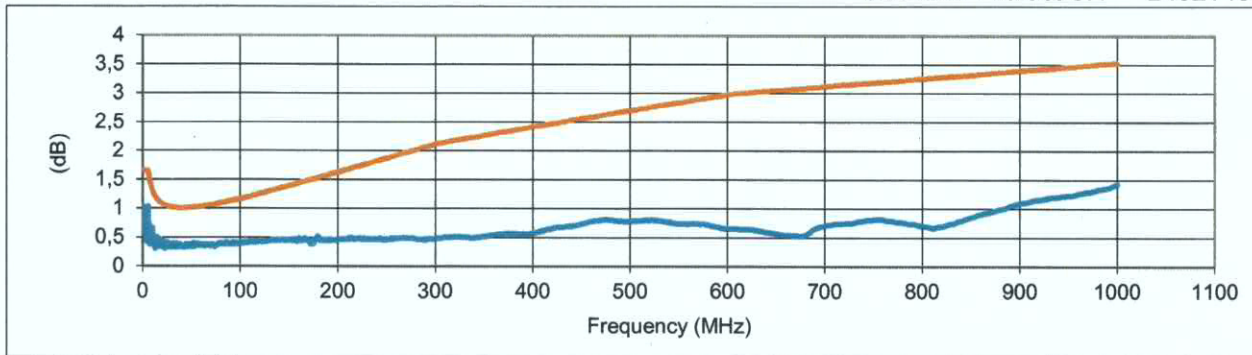

CMRL

CMDMRL Artifact SN **2409153**

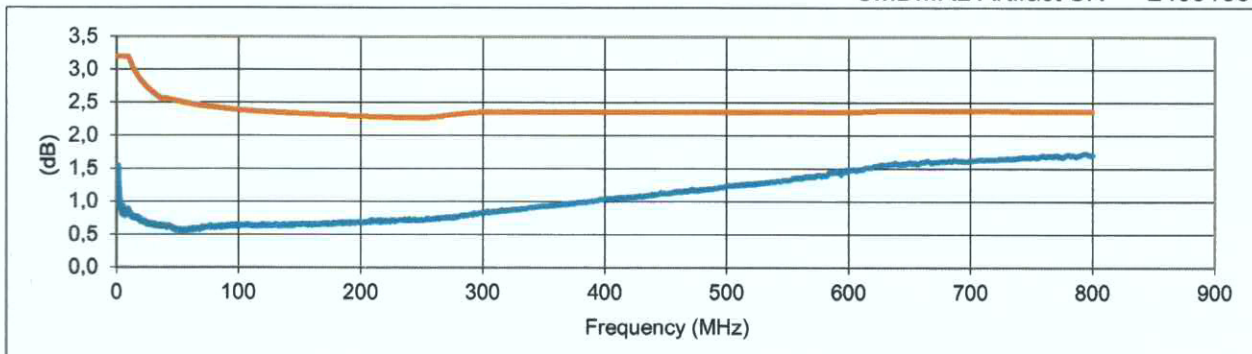

- Measured difference of DSX and reference laboratory equipment added to measurement accuracy of reference laboratory equipment. Worst accuracy at each frequency shown.
- Corresponding measurement accuracy requirement for nominally compliant Level IV or Level 2G/VI field tester.

As-Left Report

Model

DSX-5000 CAT 6A/CLASS Fa 1000MHz Copper Module

Serial Number


2405199

Test date 1-Jul-19

Page 2 of 3

RL


CMDMRL Artifact SN 2409153

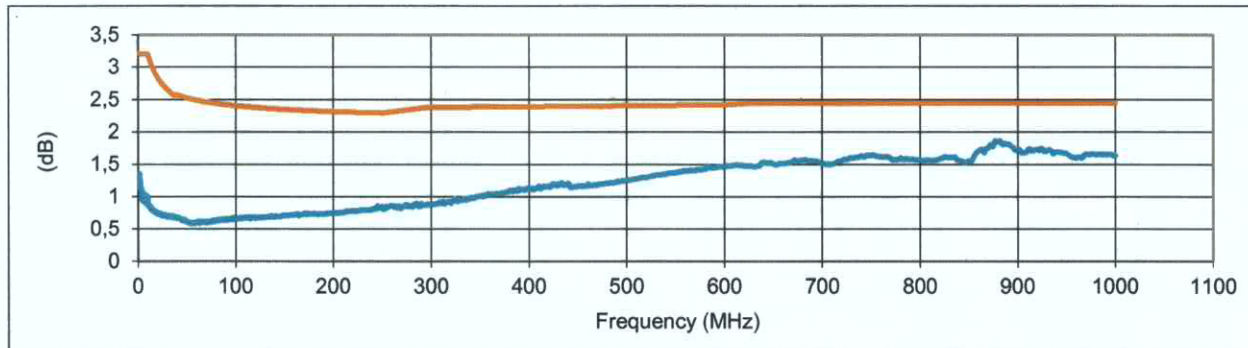

Pass Worst margin: 0.580 at 877 MHz in pair 12. Worst accuracy at each frequency shown.

TCL


TCL Artifact SN 2402080

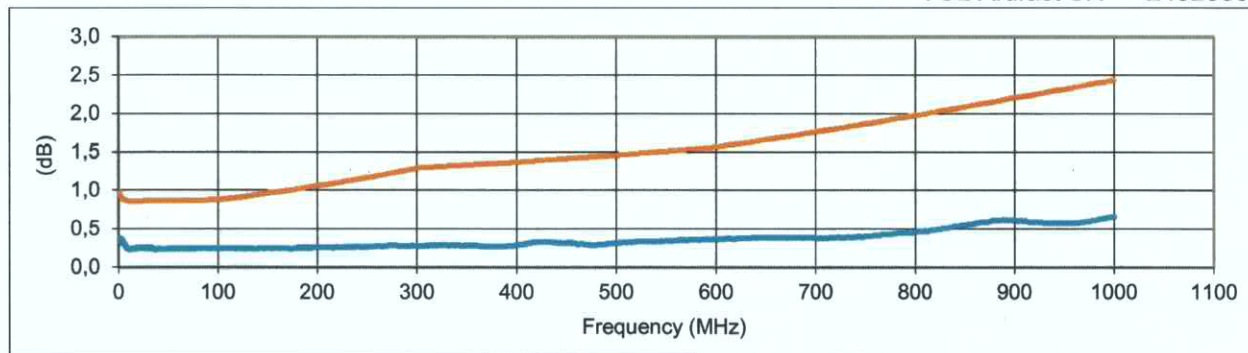

Pass Worst margin: 0.540 at 4.13 MHz in pair 45. Worst accuracy at each frequency shown.

IL

ILFEXT Artifact SN 2402053

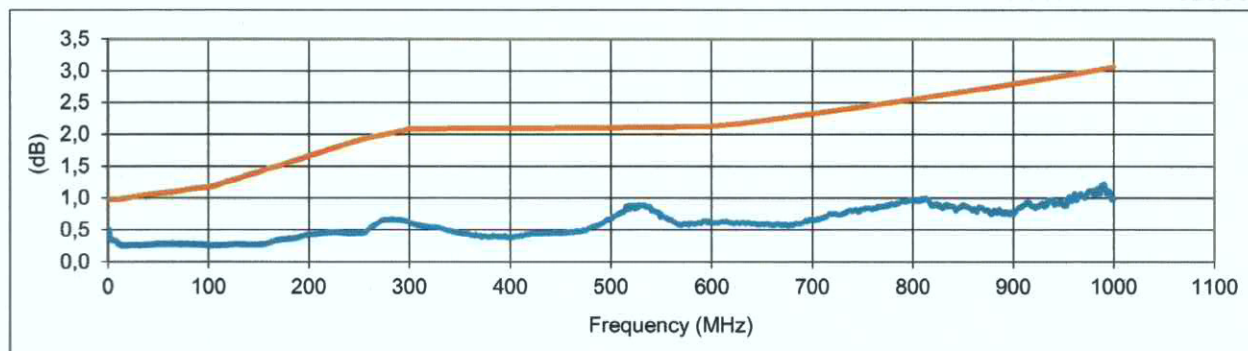

Pass Worst margin: 0.470 at 1 MHz in pair 78. Worst accuracy at each frequency shown.

- Measured difference of DSX and reference laboratory equipment added to measurement accuracy of reference laboratory equipment. Worst accuracy at each frequency shown.
- Corresponding measurement accuracy requirement for nominally compliant Level IV or Level 2G/VI field tester.

As-Left Report

Model **DSX-5000 CAT 6A/CLASS Fa 1000MHz Copper Module**


Serial Number **2405199**

Test date **1-Jul-19**

Page 3 of 3

FEXT

ILFEXT Artifact SN **2402053**

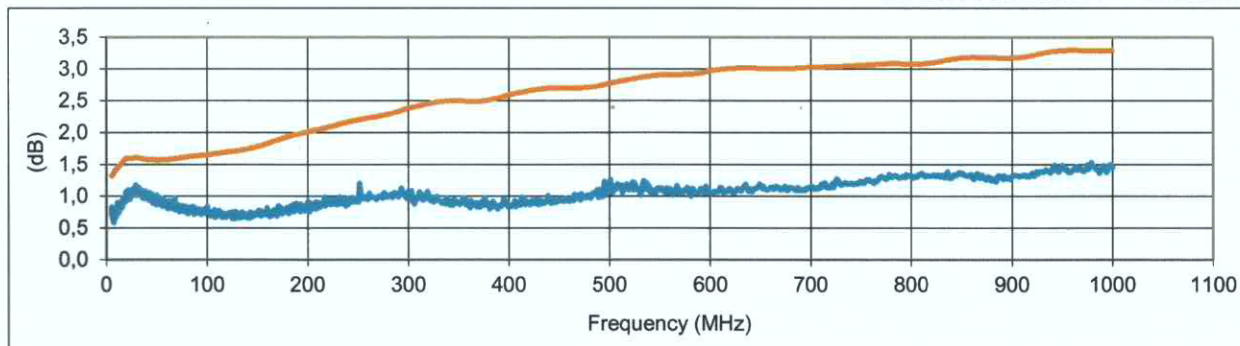

Pass Worst margin: 0.430 at 28.88 MHz in pair 78-36. Worst accuracy at each frequency shown.

— Measured difference of DSX and reference laboratory equipment added to measurement accuracy of reference laboratory equipment. Worst accuracy at each frequency shown.

— Corresponding measurement accuracy requirement for nominally compliant Level IV or Level 2G/VI field tester.

Loop Resistance

Loop Resistance Artifact SN **2402252**

	Measured	Expected	Limit	
Resistance on pair 12	0,12	0,00	0,80	Pass
Resistance on pair 36	49,98	49,80	0,60	Pass
Resistance on pair 45	99,91	99,80	1,60	Pass
Resistance on pair 78	453,13	453,00	4,00	Pass

Resistance imbalance

Resistance Unbalance Artifact SN **2402284**

	Measured	Expected	Limit	
Resistance on pair 12	0,12	0,00	0,80	Pass
Resistance on pair 36	25,01	24,90	0,90	Pass
Resistance on pair 45	12,19	12,13	0,90	Pass
Resistance on pair 78	24,01	24,05	0,90	Pass
Resistance imbalance on pair 12	0,01	0,00	0,05	Pass
Resistance imbalance on pair 36	0,01	0,00	0,13	Pass
Resistance imbalance on pair 45	0,32	0,32	0,06	Pass
Resistance imbalance on pair 78	0,85	0,85	0,12	Pass

DSX-8000 only: M_IL and M_FEXT measurements validate the ability of the DSX-8000 to make measurements with DSX-5000 adapters.

M IL Not applicable

M_ILFEXT Artifact SN **-**

M FEXT Not applicable

M_ILFEXT Artifact SN **-**

Test Program **TFSTest v2.5.7025**

DSX Report Form **v3.05 18-May-2017**

ID кабеля	Сводка	Врем. предел	Длина	Запас	Дата / Время
NETLINK UTP CAT.5E- 93,9 M.	PASS	TIA Cat 5e Perm. Link	93.9 m	5.8 dB (NEXT)	01.11.2019 10:20 AM
NETLINK UTP CAT.6-89,9 M.	PASS*	TIA Cat 6 Perm. Link	88.9 m	9.2 dB (NEXT)	01.11.2019 10:49 AM
NETLINK UTP CAT.6-87,7 M.	PASS	TIA Cat 6 Perm. Link	87.7 m	9.7 dB (NEXT)	01.11.2019 10:55 AM

Суммарная длина:	270.5 m
Количество отчетов:	3
Количество отчетов PASS:	3
Количество отчетов FAIL:	0
Количество отчетов с предупреждениями:	0
Только документация:	0



ИД кабеля: NETLINK UTP CAT.5E- 93,9 М.

Дата / Время: 01.11.2019 10:20:57 AM

Запас 5.8 dB (NEXT 45-78)

Врем. предел: TIA Cat 5e Perm. Link

Тип кабеля: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Оператор: SHARAEV

Версия ПО: V6.4 Build 4

Версия пределов тестирования: V7.4

Дата калибровки:

Осн. (Модуль): 01.07.2019

Удален. (Модуль): 01.07.2019

Сводка теста: PASS

Модель: DSX-5000

S/N основного модуля: 2405199

S/N удаленного модуля: 2405169

Основной модуль: DSX-PLA004

Удаленный модуль: DSX-PLA004

Длина (м), Лимит 90.0	[Пара 36]	93.9
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 12]	468
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 12]	14
Соппротивл. (Ом)	[Пара 12]	17.18
Вносимые потери Запас (дБ)		
	[Пара 12]	1.0
Частота (МГц)	[Пара 12]	100.0
Предел (дБ)	[Пара 12]	21.0





Схема разводки (T568B)



PASS

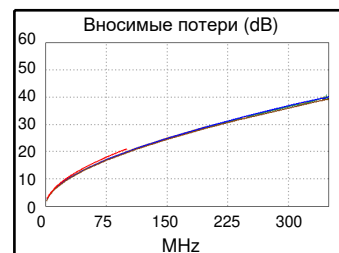

Наихудш. разн Наихудш. знач

PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	45-78	45-78	36-78	36-78
NEXT (dB)	9.4	5.8	12.3	12.2
Част. (МГц)	39.5	39.3	97.8	97.0
Предел (дБ)	38.9	38.9	32.5	32.5
наихудшая пара	78	45	36	78
PS NEXT (dB)	10.8	8.5	12.8	14.6
Част. (МГц)	39.5	39.3	98.0	97.0
Предел (дБ)	35.9	35.9	29.4	29.5









PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	78-45	45-78	78-45	45-78
ACR-F (dB)	14.9	15.2	16.1	16.4
Част. (МГц)	65.8	65.8	100.0	100.0
Предел (дБ)	22.3	22.3	18.6	18.6
наихудшая пара	45	36	45	45
PS ACR-F (dB)	15.1	15.4	16.8	17.0
Част. (МГц)	65.8	1.0	100.0	100.0
Предел (дБ)	19.3	55.6	15.6	15.6

-	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	45-78	45-78	36-78	36-78
ACR-N (dB)	10.2	6.6	13.8	13.6
Част. (МГц)	39.5	39.3	97.8	97.0
Предел (дБ)	26.2	26.3	11.7	11.9
наихудшая пара	78	45	36	36
PS ACR-N (dB)	11.6	9.1	14.1	16.0
Част. (МГц)	39.5	39.3	98.0	97.0
Предел (дБ)	23.2	23.3	8.7	8.9

PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	78	78	36	78
RL (dB)	7.2	7.6	7.6	9.9
Част. (МГц)	3.4	3.5	75.5	53.3
Предел (дБ)	19.0	19.0	13.2	14.7

Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive

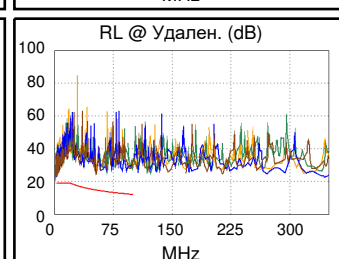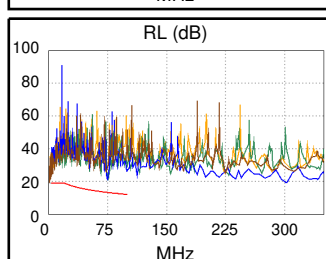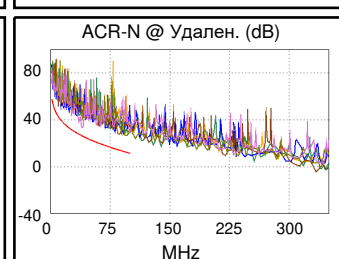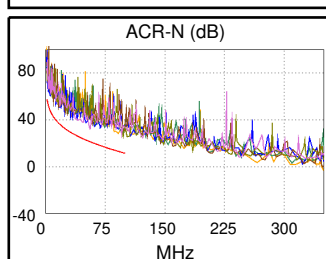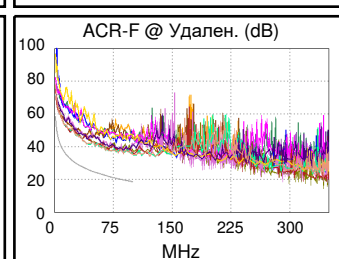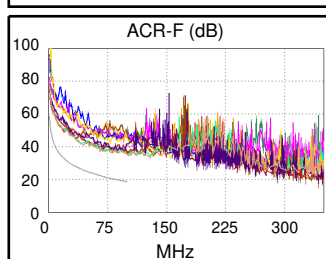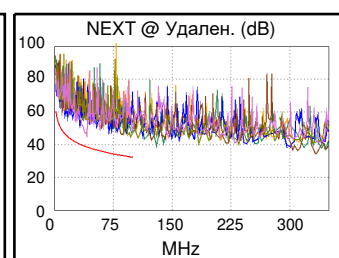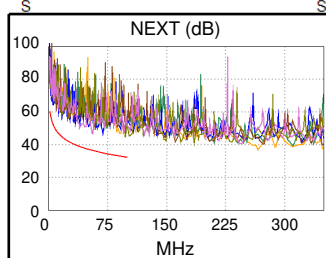



ИД кабеля: NETLINK UTP CAT.6-89,9 М.

Дата / Время: 01.11.2019 10:49:02 AM

Запас 9.2 dB (NEXT 12-78)

Врем. предел: TIA Cat 6 Perm. Link

Тип кабеля: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Оператор: SHARAEV

Версия ПО: V6.4 Build 4

Версия пределов тестирования: V7.4

Дата калибровки:

Осн. (Модуль): 01.07.2019

Удален. (Модуль): 01.07.2019

Сводка теста: PASS

Модель: DSX-5000

S/N основного модуля: 2405199

S/N удаленного модуля: 2405169

Основной модуль: DSX-PLA004

Удаленный модуль: DSX-PLA004

Длина (м), Лимит 90.0	[Пара 78]	88.9
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 36]	462
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 36]	32
Соппротивл. (Ом)	[Пара 36]	13.74
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 36]	0.4*
Частота (МГц)	[Пара 36]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 36]	31.1






Схема разводки (T568B)

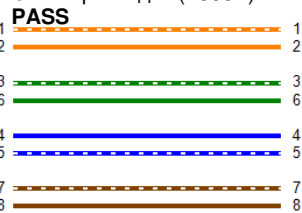

Вносимые потери (дБ)

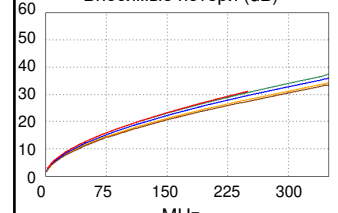

Наихудш. разн Наихудш. знач

PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	36-45	12-78	36-45	12-36
NEXT (dB)	10.3	9.2	12.6	11.2
Част. (МГц)	80.5	30.9	226.5	245.0
Предел (дБ)	43.4	50.1	36.0	35.5
наихудшая пара	45	78	36	36
PS NEXT (dB)	11.2	10.9	12.2	11.2
Част. (МГц)	89.0	30.8	226.5	245.0
Предел (дБ)	40.1	47.7	33.4	32.9









PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	78-12	78-12	12-78	78-12
ACR-F (dB)	9.3	9.1	9.7	9.2
Част. (МГц)	222.0	238.0	238.0	238.5
Предел (дБ)	17.3	16.7	16.7	16.6
наихудшая пара	12	12	12	12
PS ACR-F (dB)	11.5	11.1	11.6	11.4
Част. (МГц)	222.0	226.0	222.5	238.5
Предел (дБ)	14.3	14.1	14.2	13.6

-	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	36-45	12-78	12-36	12-36
ACR-N (dB)	11.0	10.4	14.3	11.7
Част. (МГц)	80.5	30.9	250.0	245.0
Предел (дБ)	26.9	40.2	4.2	4.7
наихудшая пара	36	36	36	36
PS ACR-N (dB)	11.7	11.6	13.5	12.2
Част. (МГц)	76.0	239.5	250.0	250.0
Предел (дБ)	25.3	2.7	1.6	1.6

PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	78	78	78	78
RL (dB)	0.9*	2.9	0.9	2.9
Част. (МГц)	74.0	62.3	74.0	62.3
Предел (дБ)	15.3	16.1	15.3	16.1

Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

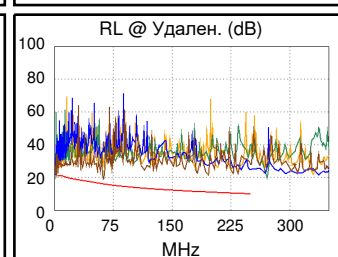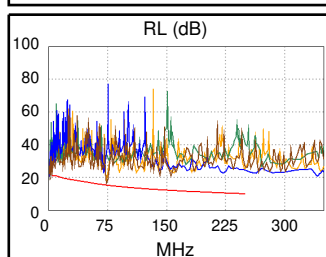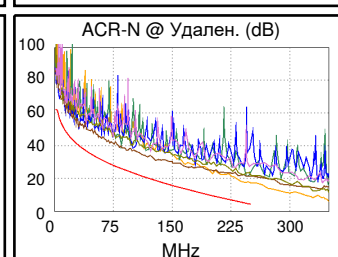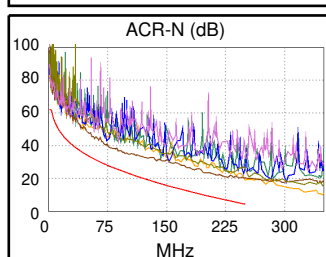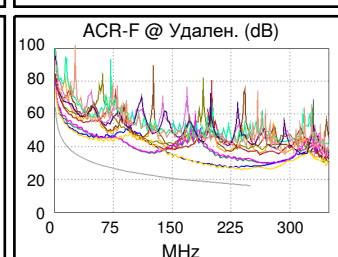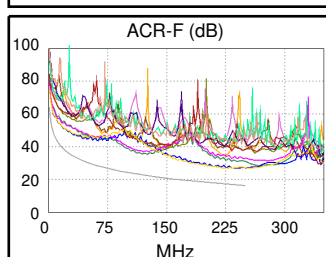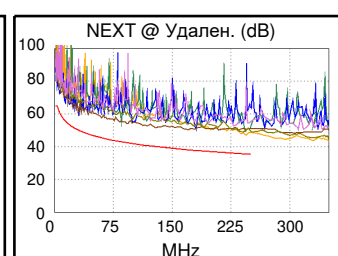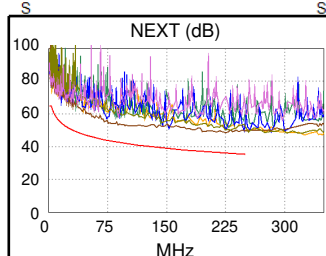

* Измерение в диапазоне точности прибора.

LinkWare™ PC Версия 10.2



ИД кабеля: NETLINK UTP CAT.6-87,7 М.

Дата / Время: 01.11.2019 10:55:46 AM

Запас 9.7 dB (NEXT 12-78)

Врем. предел: TIA Cat 6 Perm. Link

Тип кабеля: Cat 6 U/UTP

NVP: 69.0%

Оператор: SHARAEV

Версия ПО: V6.4 Build 4

Версия пределов тестирования: V7.4

Дата калибровки:

Осн. (Модуль): 01.07.2019

Удален. (Модуль): 01.07.2019

Сводка теста: PASS

Модель: DSX-5000

S/N основного модуля: 2405199

S/N удаленного модуля: 2405169

Основной модуль: DSX-PLA004

Удаленный модуль: DSX-PLA004

Длина (м), Лимит 90.0	[Пара 78]	87.7
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 36]	456
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 36]	32
Сопротивл. (Ом)	[Пара 36]	13.56
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 36]	1.2
Частота (МГц)	[Пара 36]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 36]	31.1





Схема разводки (T568B)

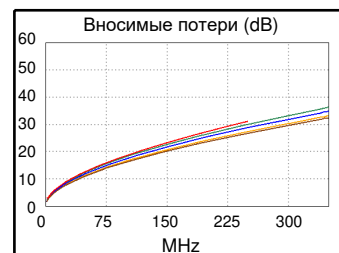

Наихудш. разн Наихудш. знач

PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	36-45	12-78	36-78	12-36
NEXT (dB)	10.2	9.7	12.6	11.3
Част. (МГц)	69.3	30.8	250.0	245.0
Предел (дБ)	44.4	50.1	35.3	35.5
наихудшая пара	36	78	36	36
PS NEXT (dB)	11.8	11.2	12.3	11.4
Част. (МГц)	69.0	30.8	250.0	245.0
Предел (дБ)	41.9	47.7	32.7	32.9

PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	78-12	78-12	12-78	78-12
ACR-F (dB)	10.7	10.4	11.4	10.6
Част. (МГц)	222.0	207.0	239.0	239.0
Предел (дБ)	17.3	17.9	16.6	16.6
наихудшая пара	12	12	12	12
PS ACR-F (dB)	12.8	12.4	12.8	12.6
Част. (МГц)	222.0	225.5	222.0	238.0
Предел (дБ)	14.3	14.1	14.3	13.7

-	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	36-45	12-78	36-45	12-36
ACR-N (dB)	11.1	11.1	16.1	12.5
Част. (МГц)	69.3	30.8	246.5	245.0
Предел (дБ)	29.2	40.2	4.6	4.7
наихудшая пара	36	36	36	36
PS ACR-N (dB)	12.0	12.3	13.5	13.1
Част. (МГц)	69.0	240.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	26.8	2.6	1.6	1.6

PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	78	78	78	78
RL (dB)	2.2	3.3	2.2	3.3
Част. (МГц)	74.0	62.3	74.0	62.3
Предел (дБ)	15.3	16.1	15.3	16.1

Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

